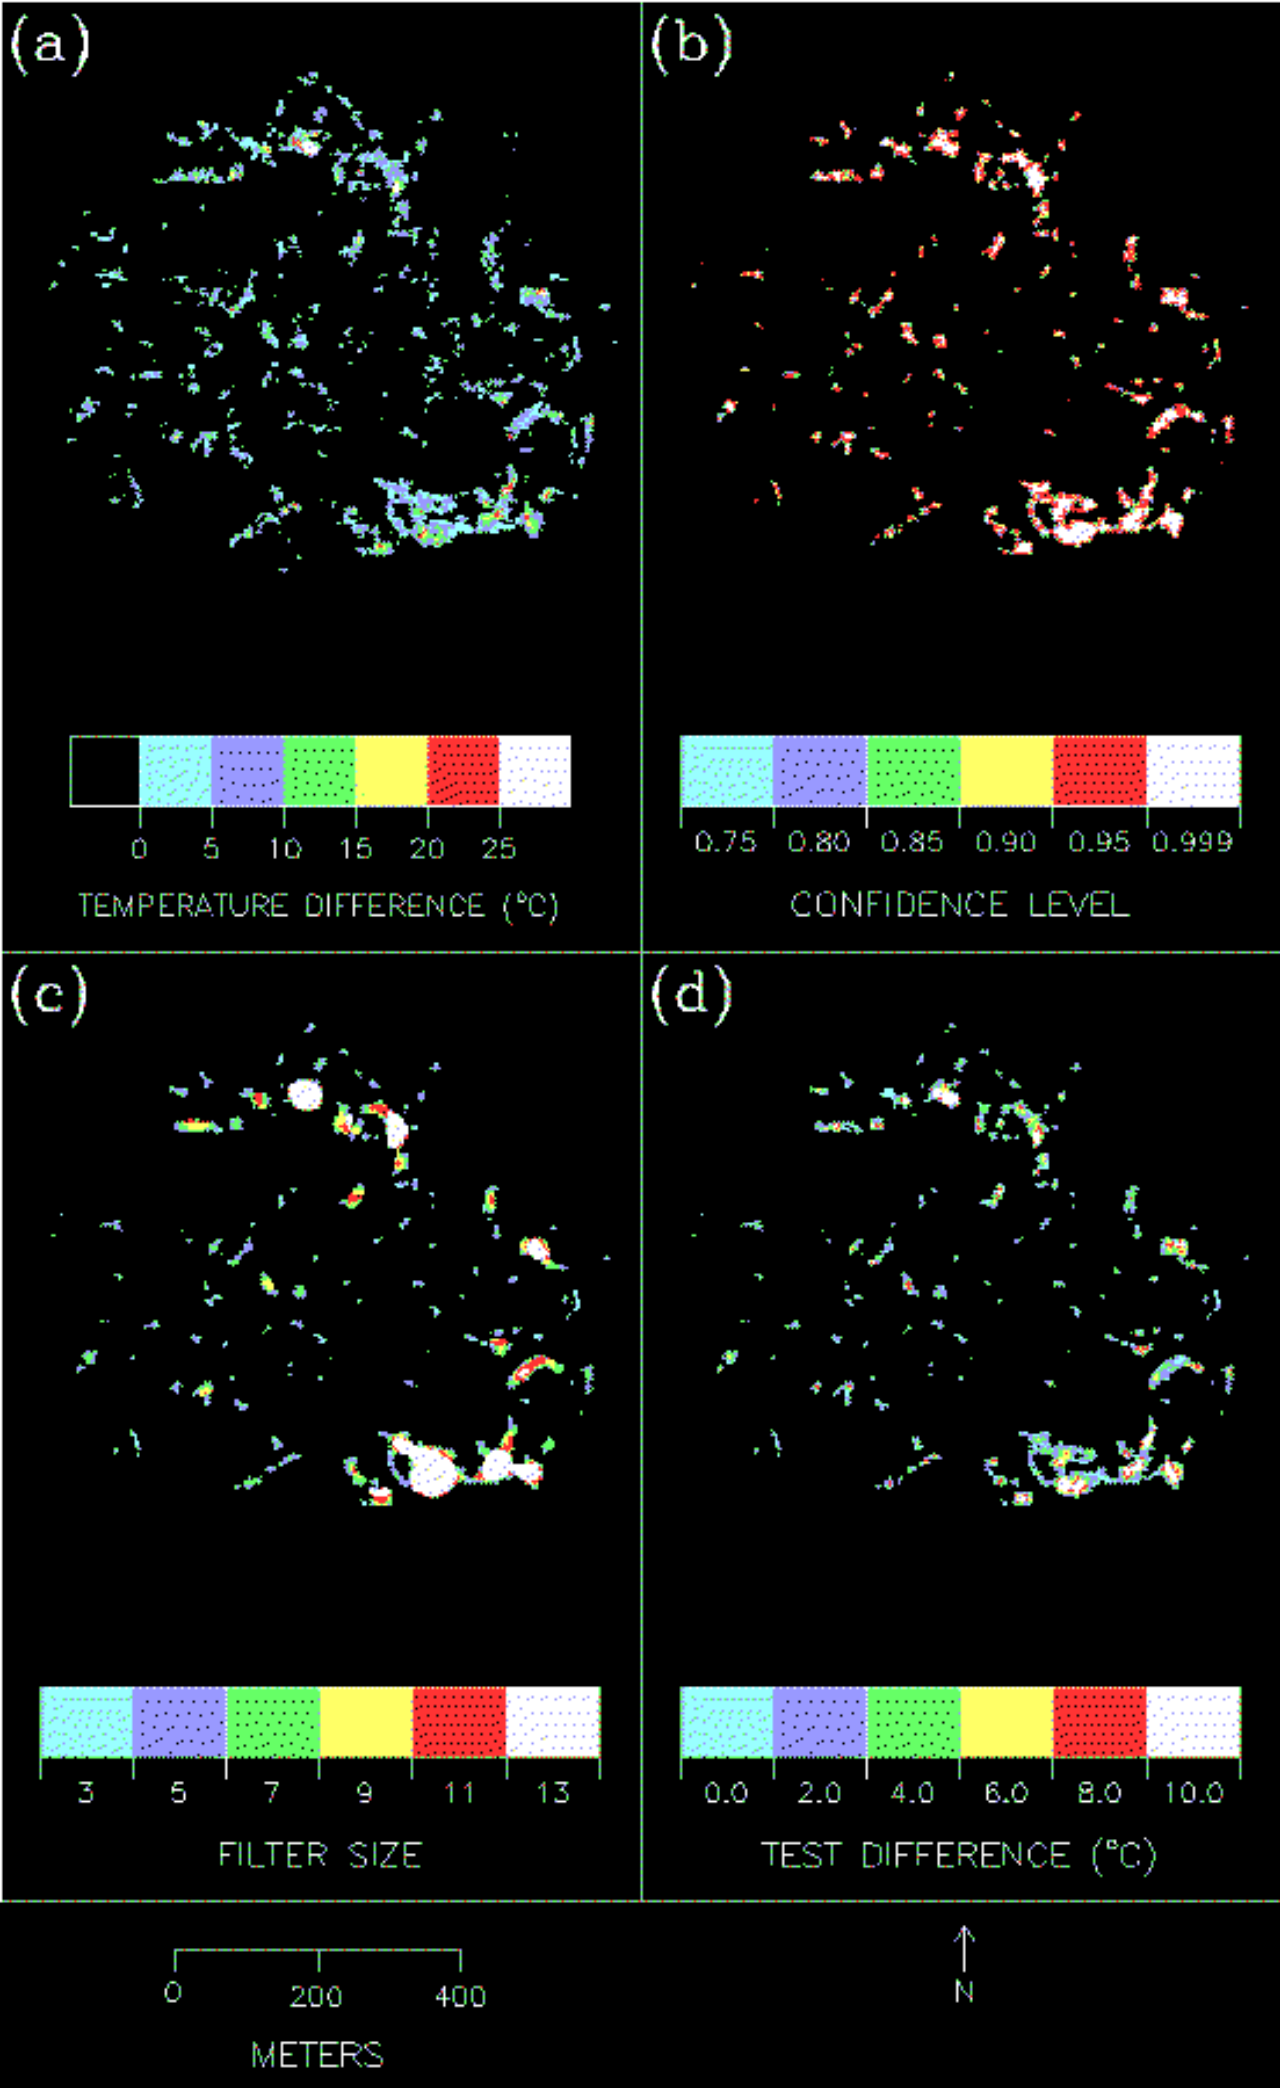
(a)
0 5 10 15 20 25
TEMPERATURE DIFFERENCE (°C)
(b)
0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 0.999
CONFIDENCE LEVEL
(c)
3 5 7 9 11 13
FILTER SIZE
(d)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
TEST DIFFERENCE (°C)
0 200 400
METERS
N